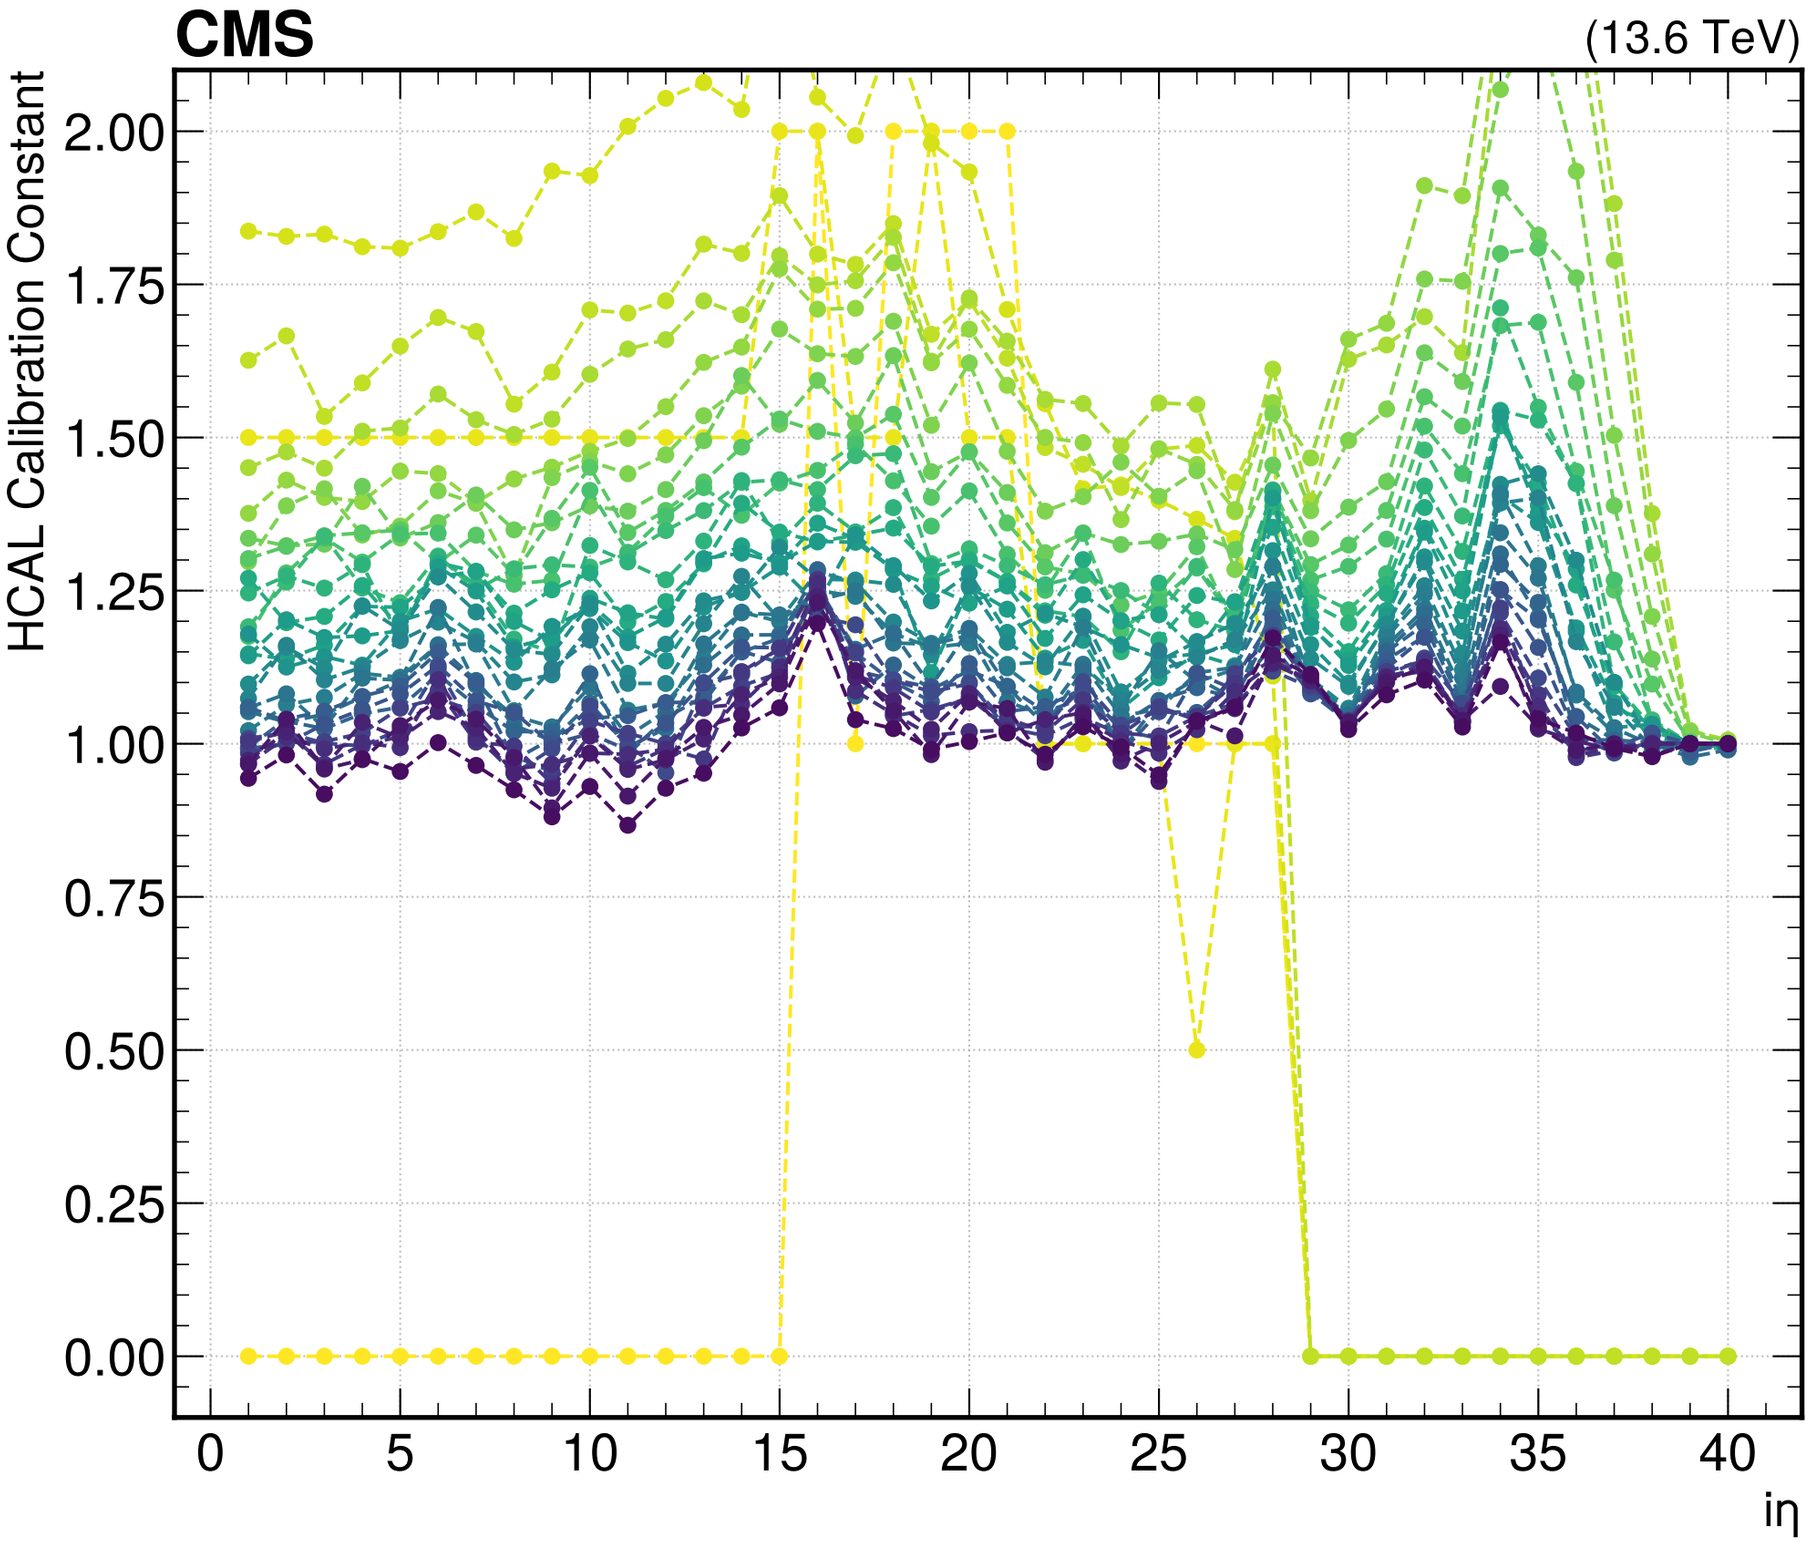
CMS
(13.6 TeV)
HCAL Calibration Constant
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
iη